


Diagnostik bei Verdacht auf Hypothyreose (nach HAHN et al. 1997)

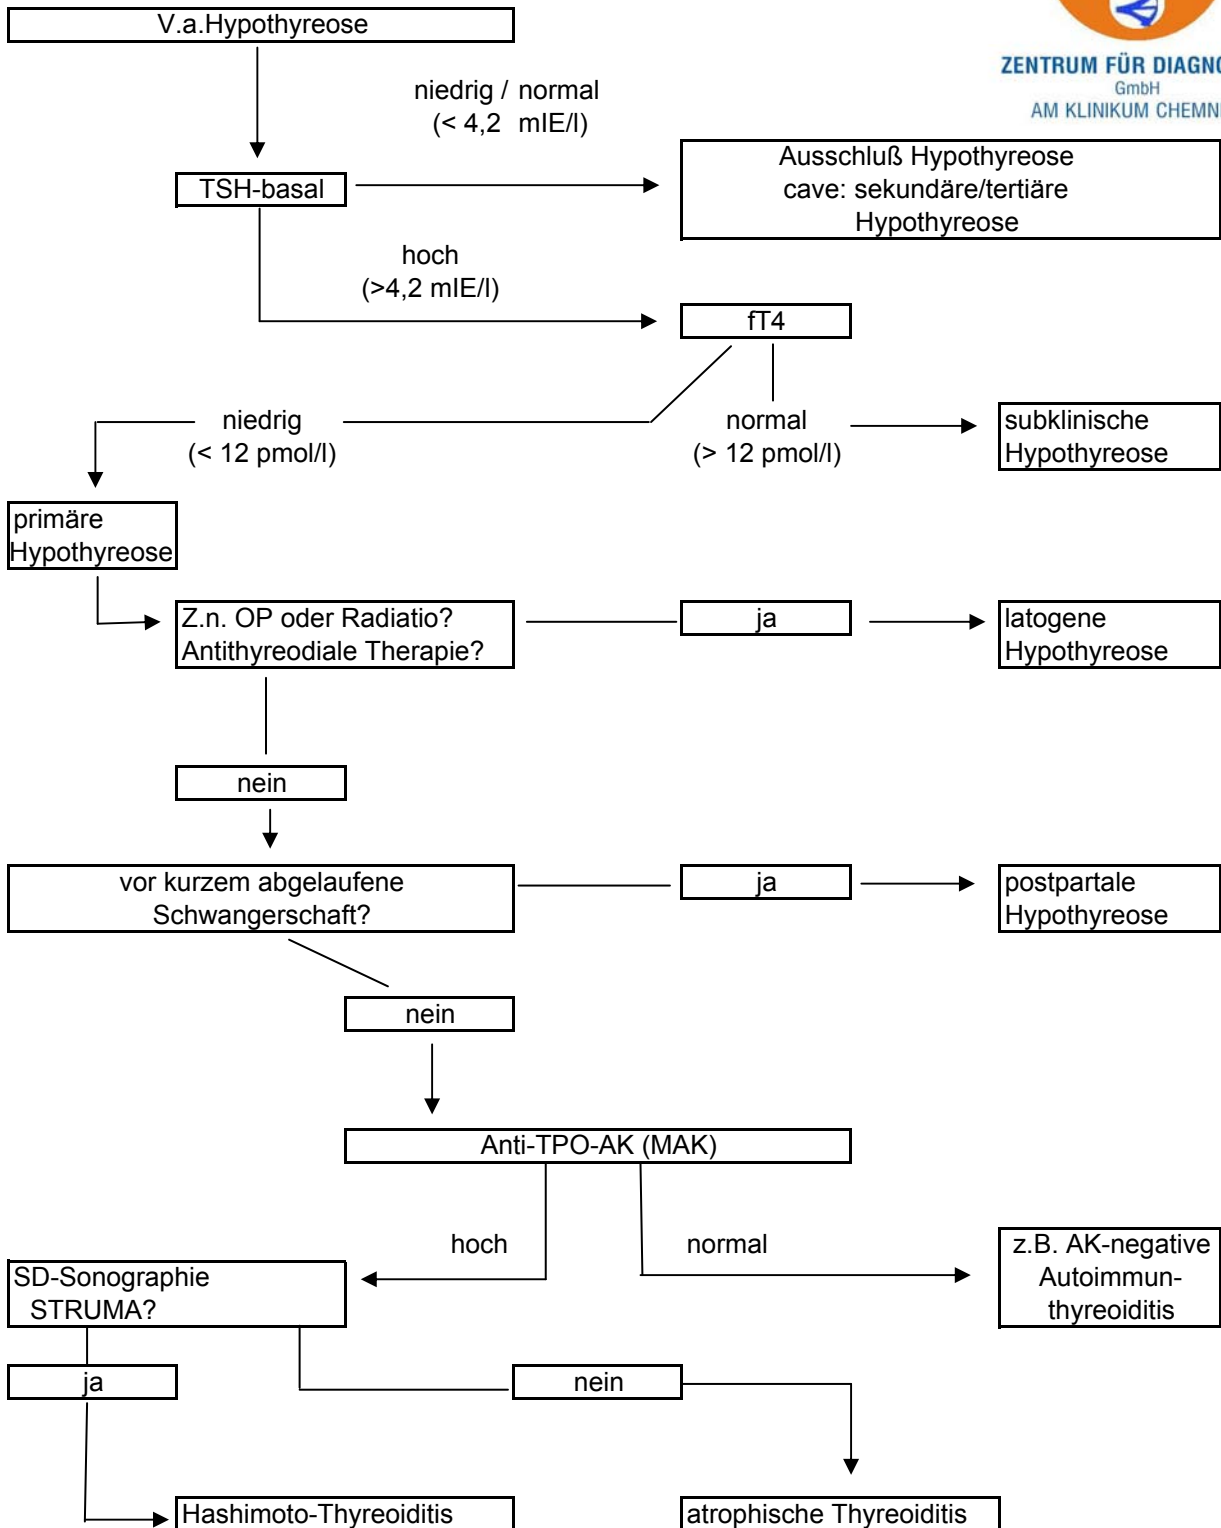

Zahlenangaben für das Immunoassay System Elecsys, Fa. Roche Diagnostics  
Geräte: Elecsys 1010, Elecsys 2010, E170